

---



## QualcoMAE jártassági vizsgálatok

### Segédlet az Elektronikus ügyintézés használatához


Első lépések.....	2
A jelentkezési lap kitöltése .....	6
A minták megérkeztenek visszaigazolása.....	10
Eredmények rögzítése .....	12
Eredmények kiértékelésének lekérdezése .....	16

## Első lépések


A [www.qualcomae.hu](http://www.qualcomae.hu) oldalon kattintsunk az **Elektronikus ügyintézés** menüpontra.

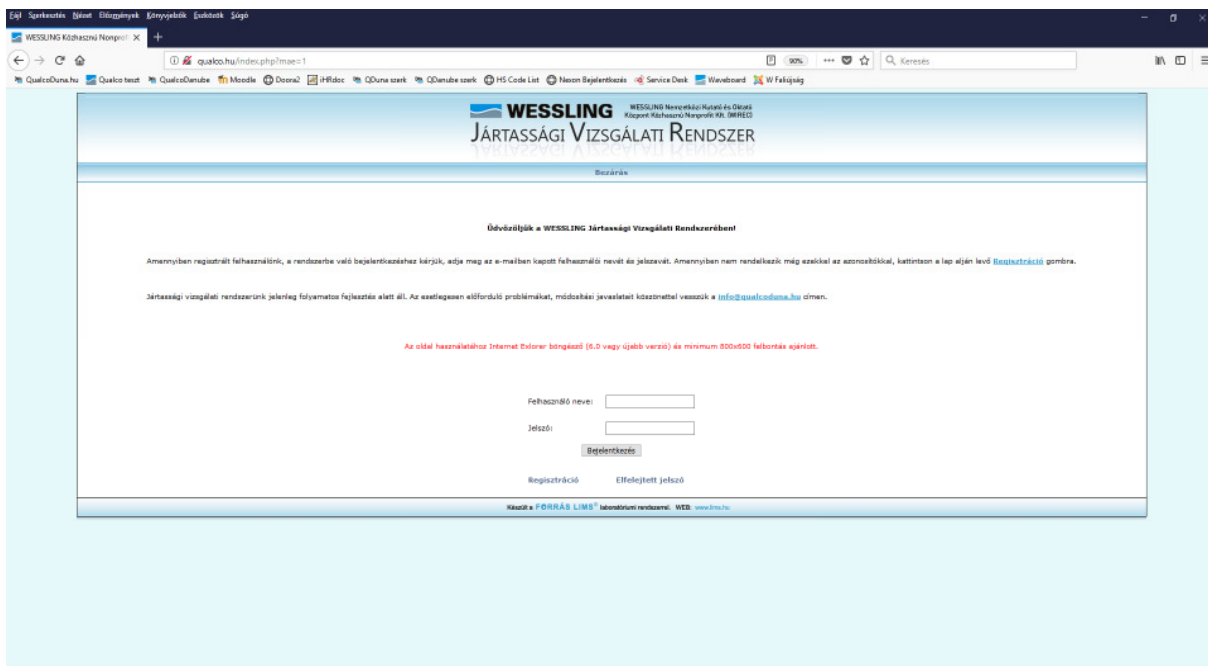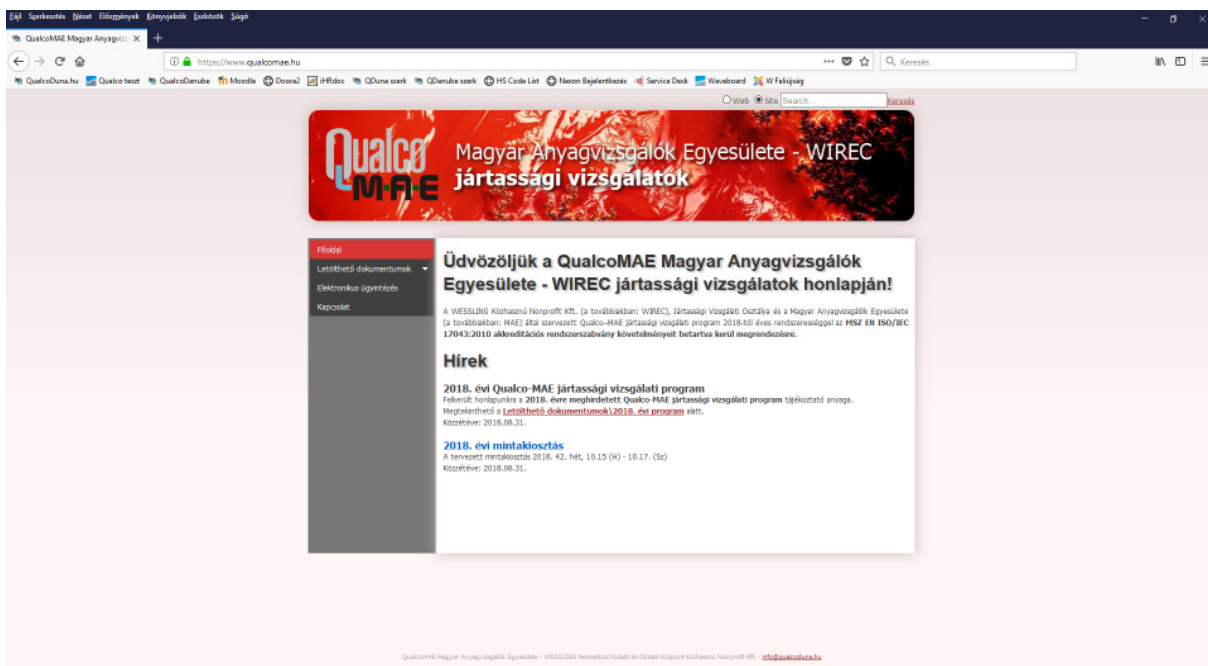


A megjelenő oldalon írjuk be a felhasználói nevünket és jelszavunkat, majd kattintsunk a Bejelentkezés gombra.

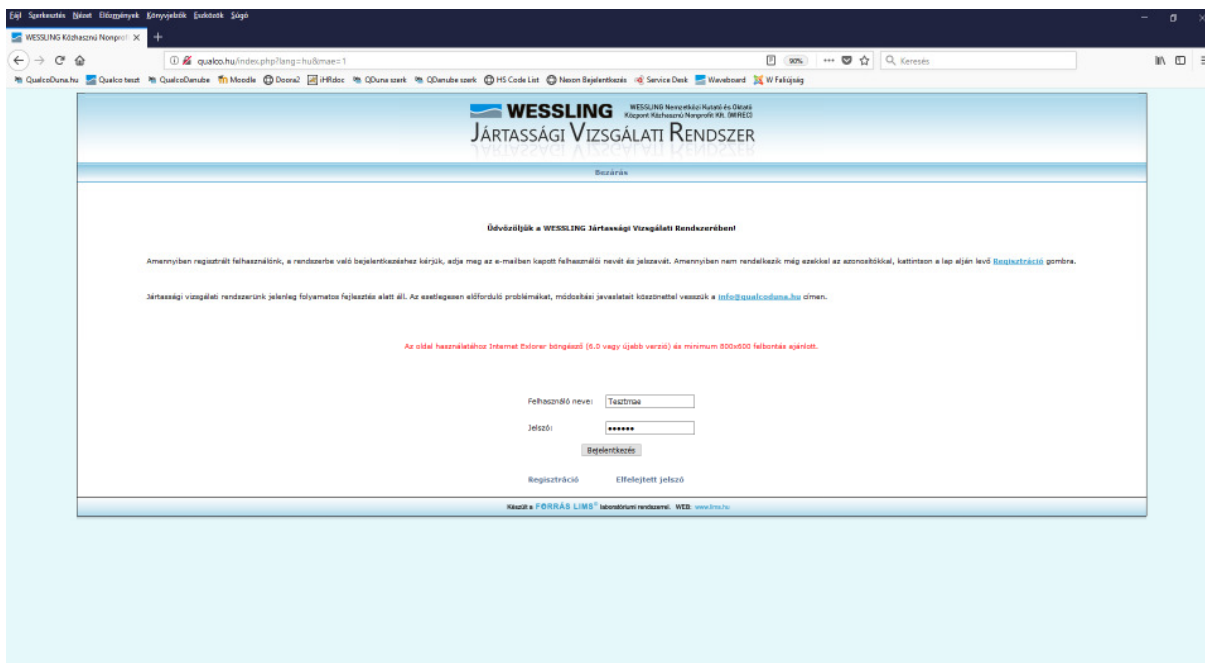


(Amennyiben még nincsen felhasználói nevünk és jelszavunk, kattintsunk a Regisztráció gombra. A megjelenő mezők kitöltése után kattintsunk az Elküld gombra.)

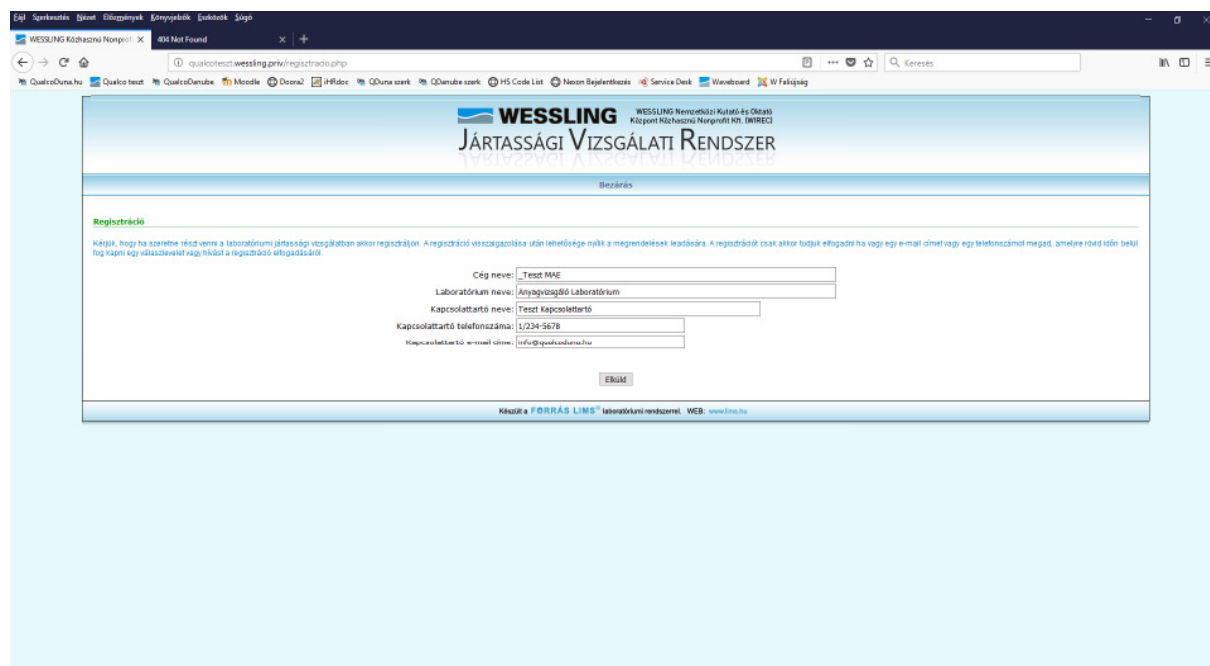


Belépés után a Főmenübe jutunk. Itt megadhatjuk vagy módosíthatjuk adatainkat, kitölthetjük elektronikusan a jártassági vizsgálati jelentkezési lapot, mérési eredményeket adhatunk meg illetve letölthetjük azok kiértékelését.

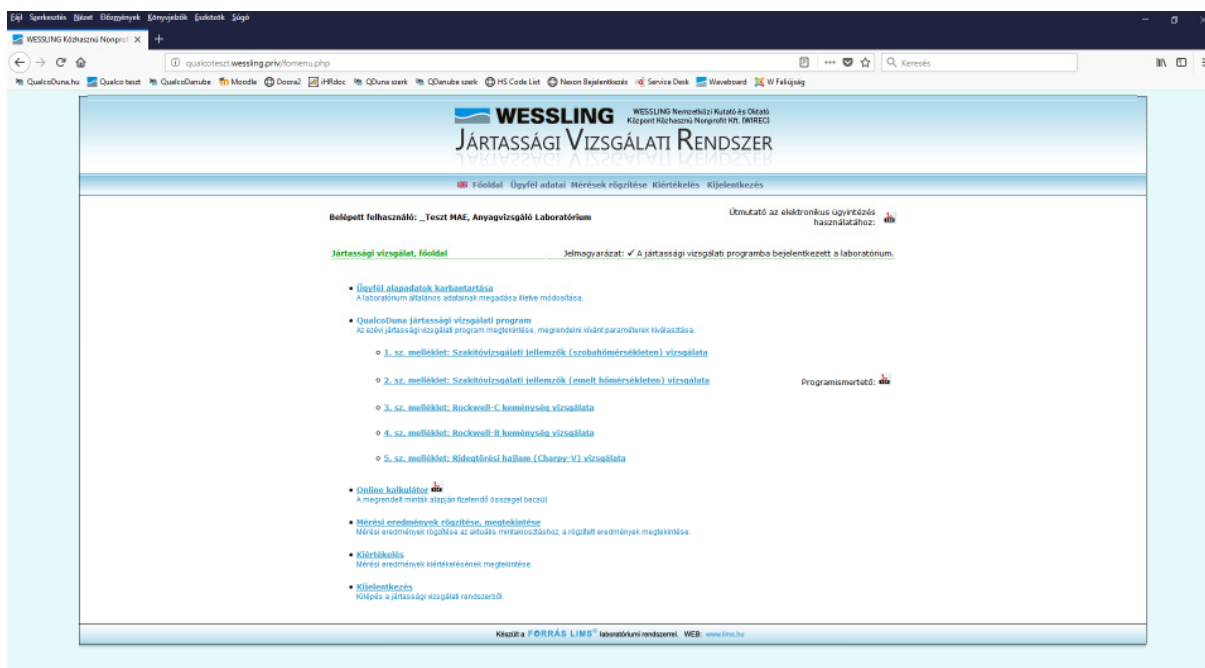

Az **Ügyfél adatai** menüpontban megadhatjuk adatainkat illetve ellenőrizhetjük azok helyességét.

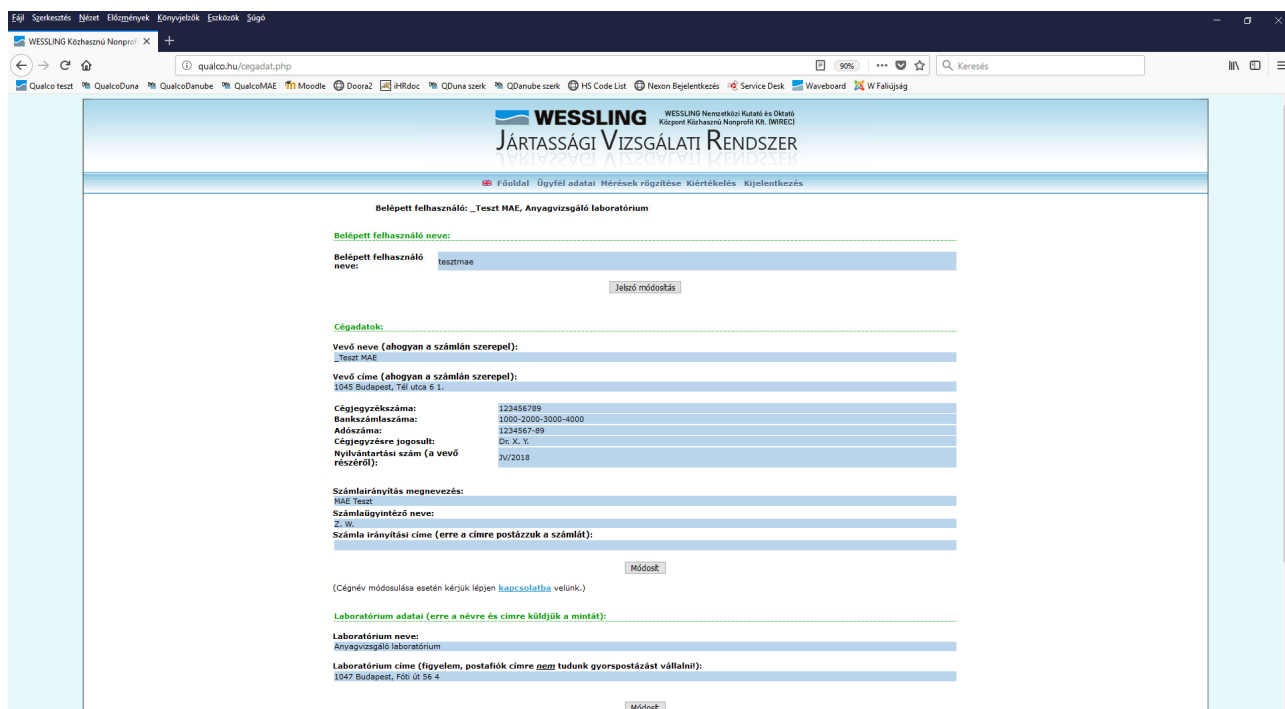

Amennyiben változtatni szeretnénk a megjelenő adatokon, a **Módosít** gomb megnyomása után tehetjük meg azt. A **Végrehajt** gomb megnyomásával menthetjük el a változásokat.

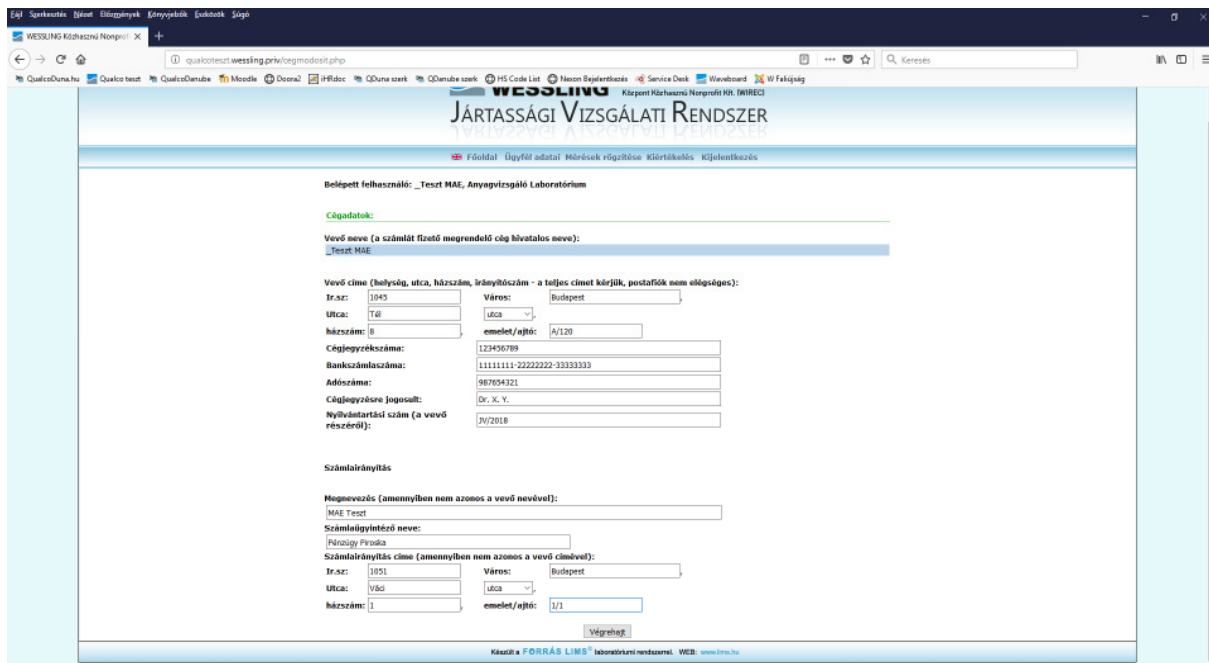

**Belépett felhasználó: \_Teszt MAE, Anyagvizsgáló Laboratórium**

**Céginformációk:**

Vevő neve (a számlát fizató megrendelő cég hivatalos neve):  
 Teszt MAE

Vevő címe (helység, utca, házszám, irányítószám - a teljes címet kérjük, postafiók nem elegendő):

Ir.sz.: 1045 Város: Budapest  
 Utca: Téli utca  
 Házszám: 8 Emelet/ajtó: A/120

Cégjegyzékszám: 123456789  
 Bankszámlaszám: 11111111-22222222-33333333  
 Adószám: 987654321  
 Cégjegyzéskönyvszám: Dr. X. Y.  
 Nyilvántartási szám (a vevő részéről): J/2018

**Számírányítás**

Megnevezés (amennyiben nem azonos a vevő nevével):  
 MAE Teszt

Számírányító neve:  
 Péterffy Pirooska

Számírányítás címe (amennyiben nem azonos a vevő címével):

Ir.sz.: 1051 Város: Budapest  
 Utca: Váci utca  
 Házszám: 1 Emelet/ajtó: 1/1

**Végrehajt**

Készítte FORRÁS LIMBS laboratóriumi rendszert. WEB: [www.fma.hu](http://www.fma.hu)

kapcsolat@mae.hu felénk.' Below the company information is a 'Laboratórium adatai' section with fields for laboratory name and address. Below that is an 'Eredményeket postal úton/faxon küldöm:' section with a 'Nem' field and a 'Módosít' button. At the bottom is a 'Kapcsolattartó adatai' section with fields for contact name, phone, fax, and email, and a 'Módosít' button." data-bbox="152 531 913 827"/>

Céginformációk:

Vevő neve (a számlát fizató megrendelő cég hivatalos neve):  
 Teszt MAE

Vevő címe (helység, utca, házszám, irányítószám - a teljes címet kérjük, postafiók nem elegendő):

Ir.sz.: 1045 Város: Budapest  
 Utca: Téli utca  
 Házszám: 8 Emelet/ajtó: A/120

Cégjegyzékszám: 123456789  
 Bankszámlaszám: 11111111-22222222-33333333  
 Adószám: 987654321  
 Cégjegyzéskönyvszám: Dr. X. Y.  
 Nyilvántartási szám (a vevő részéről): J/2018

**Számírányítás**

Megnevezés (amennyiben nem azonos a vevő nevével):  
 MAE Teszt

Számírányító neve:  
 Péterffy Pirooska

Számírányítás címe (amennyiben nem azonos a vevő címével):

Ir.sz.: 1051 Város: Budapest  
 Utca: Váci utca  
 Házszám: 1 Emelet/ajtó: 1/1

**Módosít**

[Cégnév módosulása esetén kérjük lépjen [kapcsolat@mae.hu](mailto:kapcsolat@mae.hu) felénk.]

**Laboratórium adatai (erre a névre és címre küldjük a mintát):**

Laboratórium neve:  
 Anyagvizsgáló Laboratórium

Laboratórium címe (figyelem, postafiók címre nem tudunk gyorspostázást vállalni):  
 2000 Szentendre, Virág árok 100

Eredményeket postal úton/faxon küldöm:  
 Nem

**Módosít**

**Kapcsolattartó adatai (amennyiben több kapcsolattartót szeretne rögzíteni, a kapcsolattartók adatait kérjük vesszével elválasztva megadni):**

Kapcsolattartó neve:  
 Teszt Kapcsolattartó

Telefonszám:  
 1/234-5678

Fax szám:  
 1/987-6543

E-mail cím:  
 info@qualcoduna.hu


**Módosít**

Készítte FORRÁS LIMBS laboratóriumi rendszert. WEB: [www.fma.hu](http://www.fma.hu)


## A jelentkezési lap kitöltése

A QualcoMAE jártassági vizsgálatok honlapján felhasználónevünk és jelszavunk segítségével lépünk be az Elektronikus ügyintézés menüpontba.


A Főmenüben válasszuk ki a QualcoMAE jártassági vizsgálati program alatt levő **listából** azt a **témakört**, amelyből mintákat szeretnénk rendelni (a példában Szakítóvizsgálati jellemzők (szobahőmérsékleten).

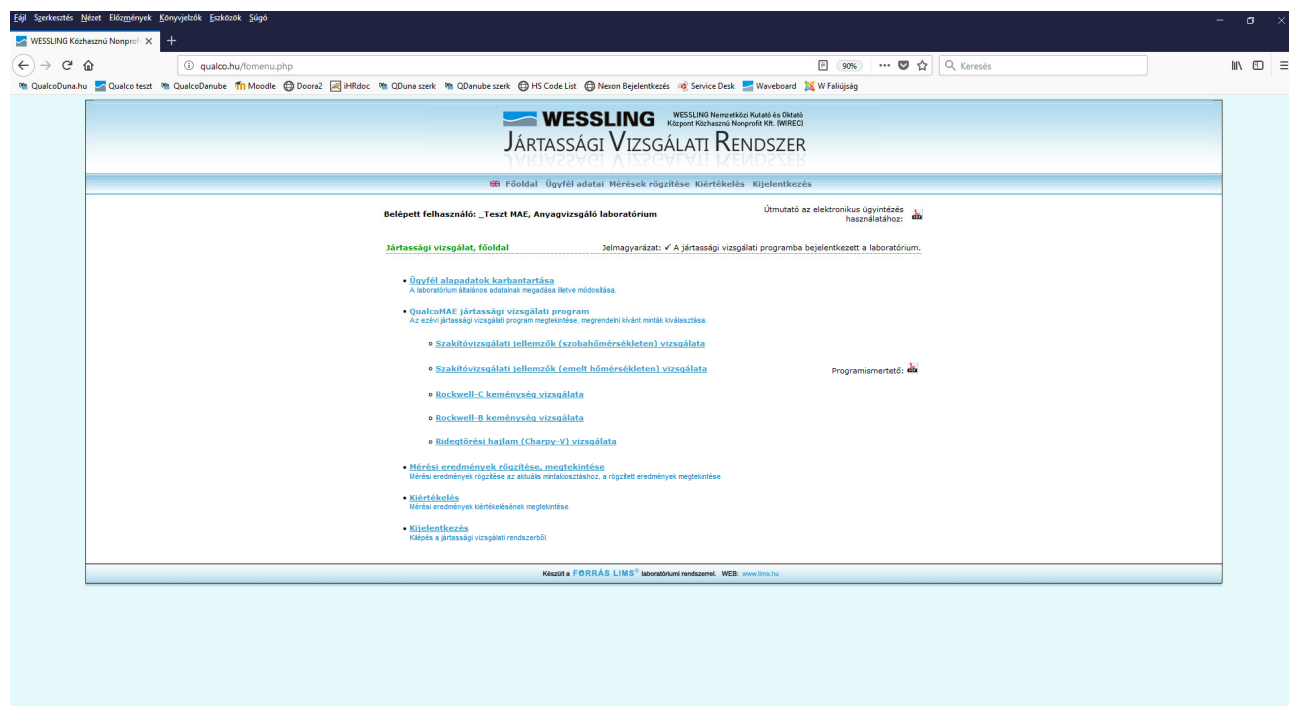


A megjelenő táblázatban a kiválasztott témakörhöz tartozó minták láthatóak. Válasszuk ki a témakörhöz tartozó **kapcsolattartót** a baloldalon levő legördülő menüből (kapcsolattartó hozzáadására vagy törlésére az Ügyfél adatai menüpontban van lehetőség, ld. korábban). Ezt követően a megrendelni kívánt minták melletti **jelölőnégyzetekbe** kattintva pipáljuk ki a megfelelő mintákat. Miután befejeztük, az **Előnézet** gombra kattintva áttekinthetjük a kijelölésünket.

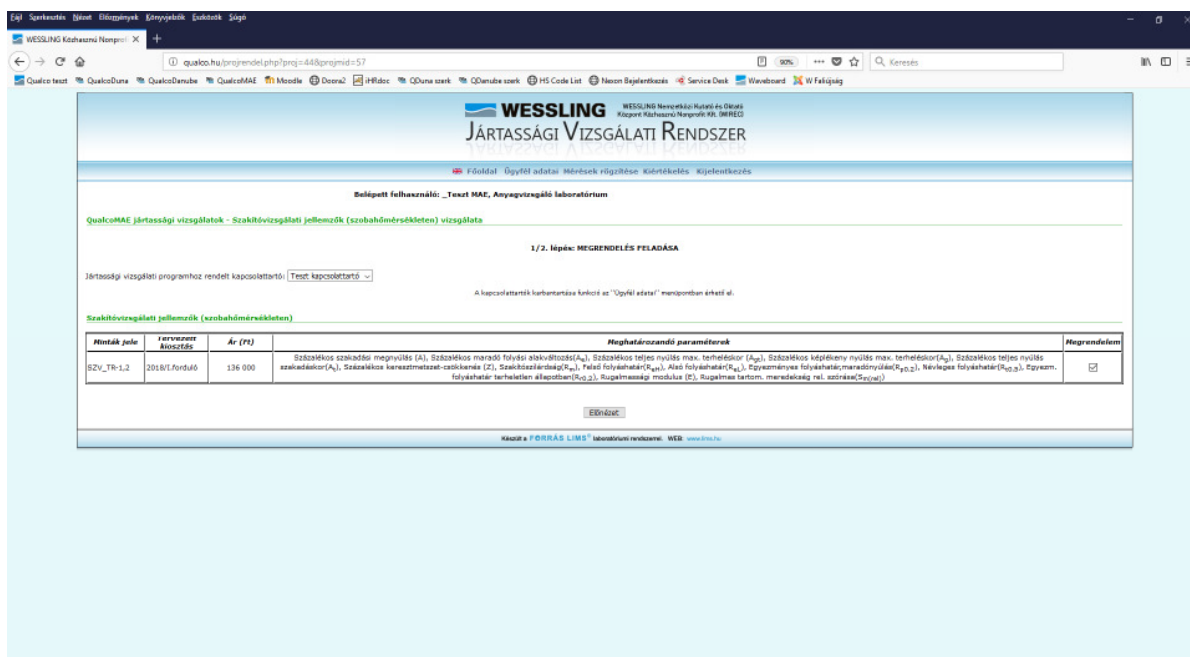


A **Vissza** gombra kattintva visszatérhetünk az előző képernyőhöz és módosíthatjuk a kijelölést, a **Rögzít** gombra kattintva pedig rögzíthetjük azt. **FIGYELEM!** A rögzítést követően a kijelölés elektronikus úton történő módosítására nincsen lehetőség. Ilyen esetben kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

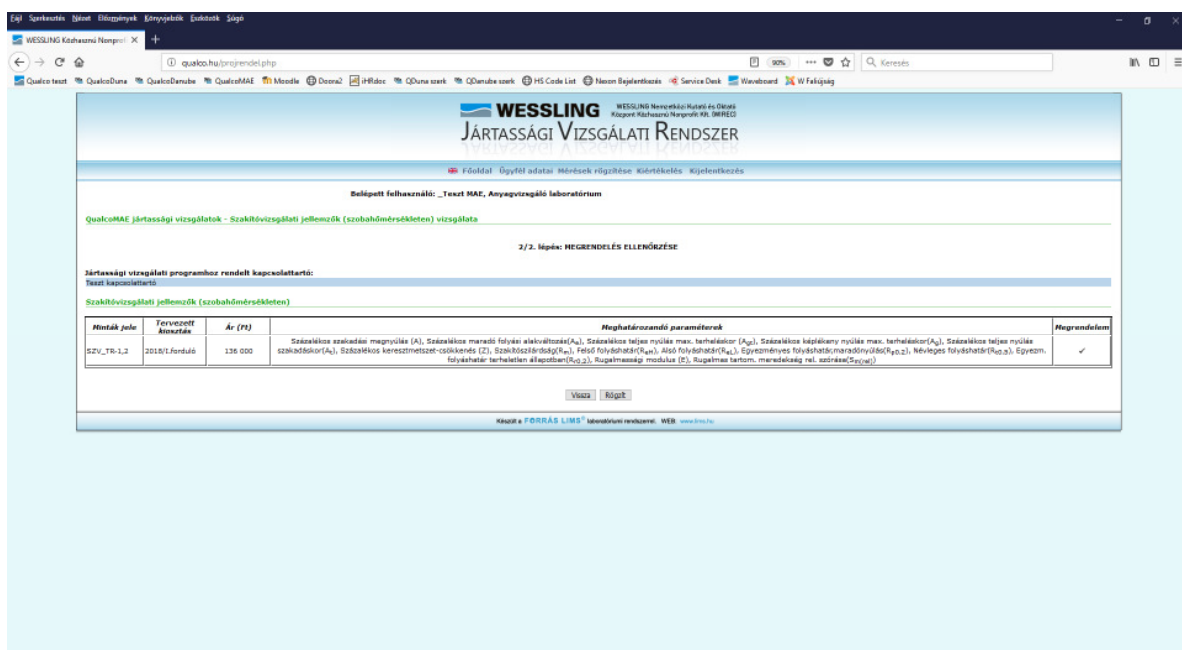

A megjelenő képernyő igazolja vissza a rögzítés tényét. Az üzenet alatti gombra kattintva visszatérhetünk a Főmenübe.

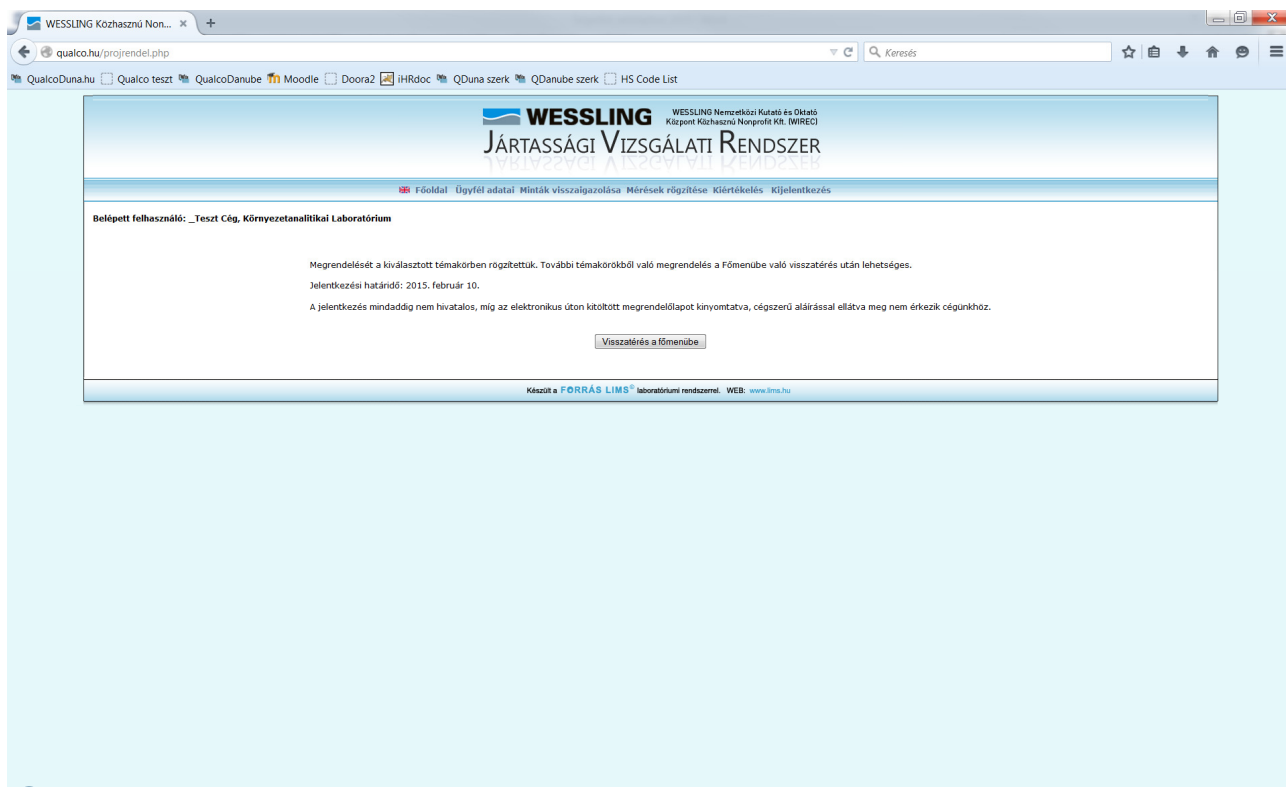


A témakör mellett megjelenő pipa jelzi, hogy adott témakorból már rendeltünk mintát.

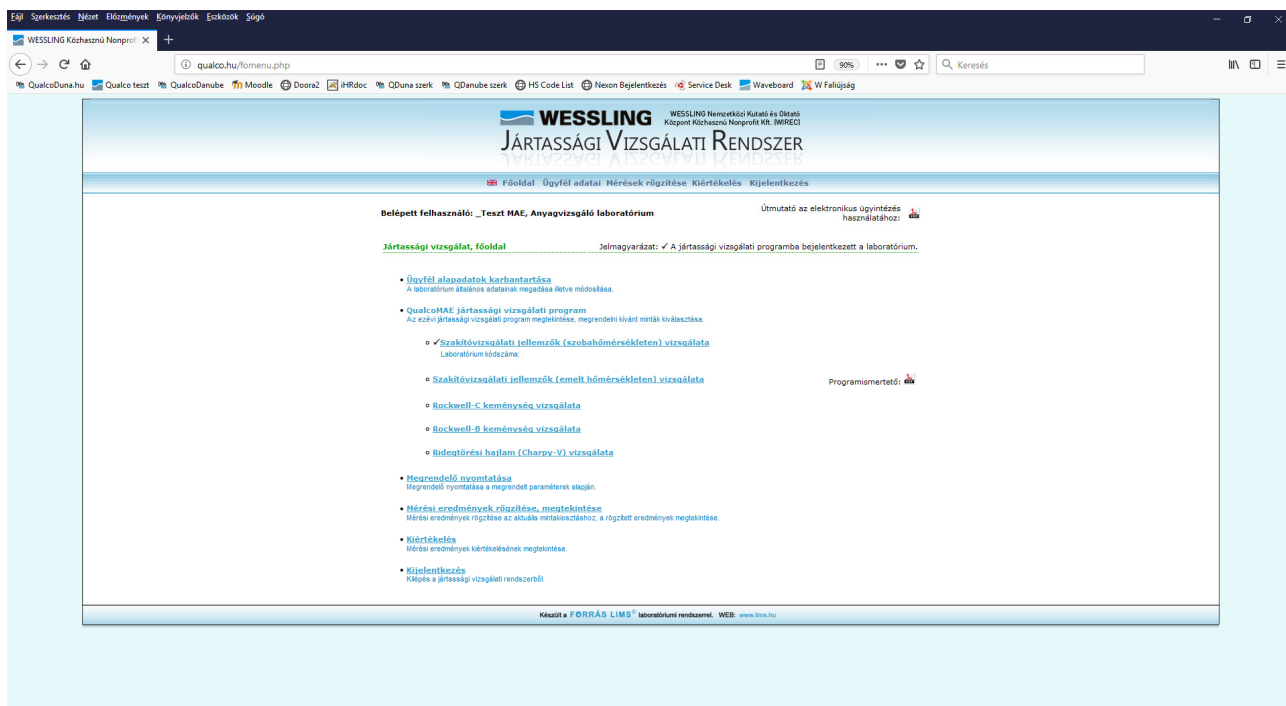



Folytathatjuk egy **másik témakörrel** vagy kinyomtathatjuk a kitöltött megrendelőlapot. Ehhez a Főmenüben kattintsunk a **Megrendelő nyomtatása** menüpontra: egy új ablakban megjelenik a kitöltött megrendelőlap **pdf** formátumban.

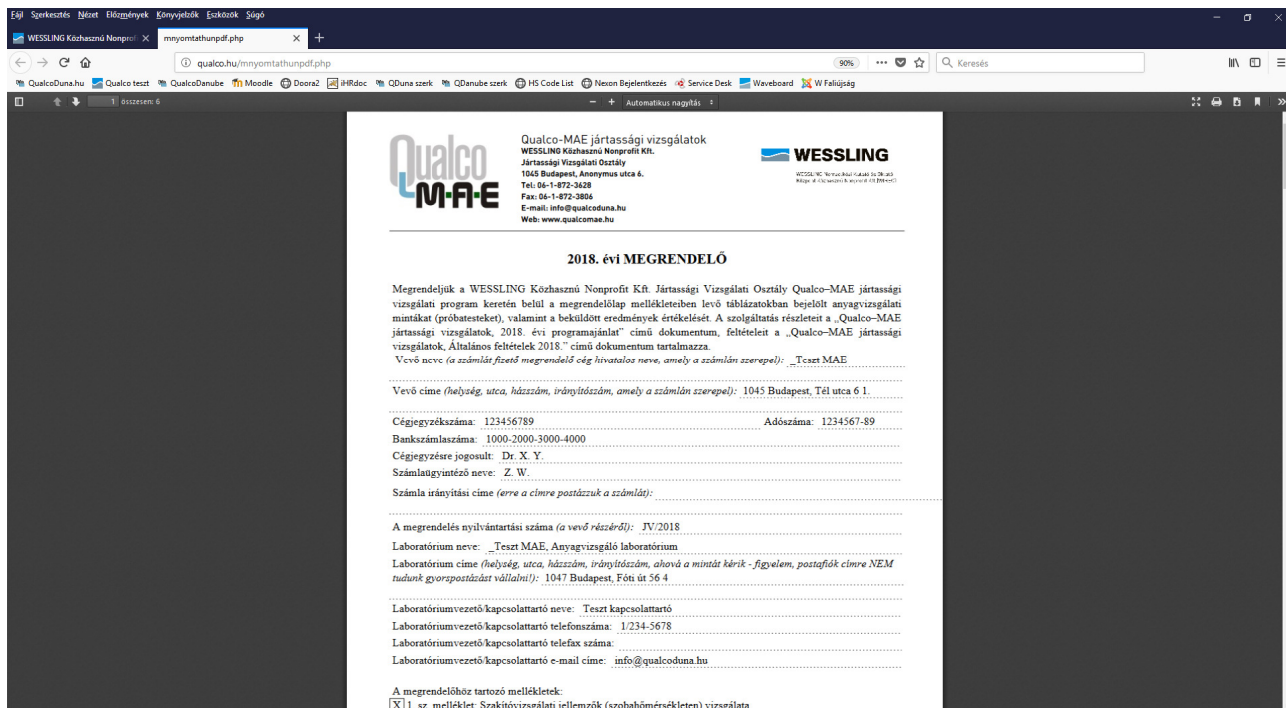


Kérjük, hogy a kinyomtatott jelentkezési lapot a megjelölt helyeken szíveskedjenek cégszerűen aláírni és postai úton, faxon, vagy szkennelést követően e-mailen visszajuttatni hozzánk. A jelentkezés a cégszerűen aláírt jelentkezési lap megérkezésével válik hivatalossá!

## A minták megérkeztenek visszaigazolása

A QualcoMAE jártassági vizsgálatok honlapján felhasználónevünk és jelszavunk segítségével lépünk be az Elektronikus ügyintézés menüpontra.

Amennyiben adott fordulóban ez az első belépésünk, a rendszer rákérdez a minták megérkezére illetve állapotára. A visszaigazolást kitöltést és a **Végrehajt** gombra kattintást követően tudjuk elküldeni:

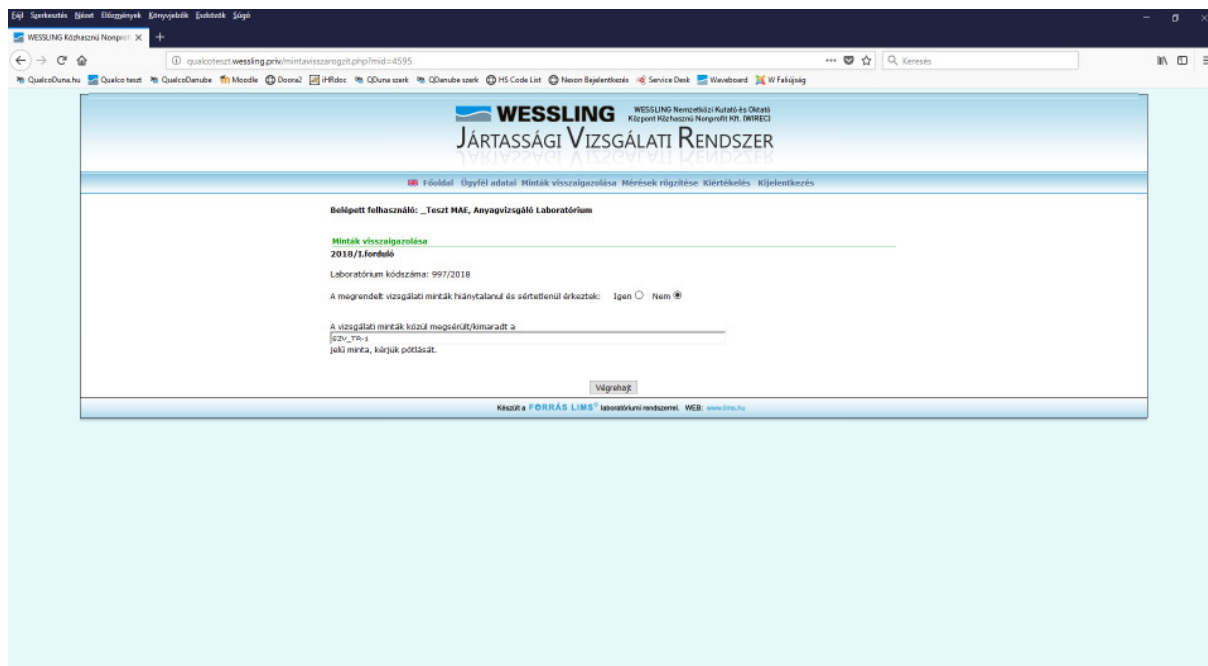

WESSLING JÁRTASSÁGI VIZSGÁLATI RENDSZER

WESSLING Nemzetközi Kutató és Oktató  
Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (WIREC)

1. oldal | Ügyfél adatai | Minták visszaigazolása | Mérések rögzítése | Kiértékelés | Kijelentkezés

Bélgérett felhasználó: \_Teszt MAE, Anyagvizsgáló Laboratórium

Minták visszaigazolása  
2018/I. forduló

Laboratórium kódja: 997/2018



A megrendelt vizsgálati minták hiánytalanul és sértetlenül érkeztek:  Igen  Nem

A vizsgálati minták közül megérkezett/hiányzott a  
[SZV\_TR-1  
jelű minta, kérjük pótlását.

Végrehajt

Készítette FORRÁS LIMS® laboratóriumi rendszerrel. WEB: [www.ima.hu](http://www.ima.hu)


A visszaigazolást a későbbiekben megtekinthetjük és igény szerint saját felhasználásra kinyomtathatjuk a **Minták visszaigazolása** menüpont alatt:

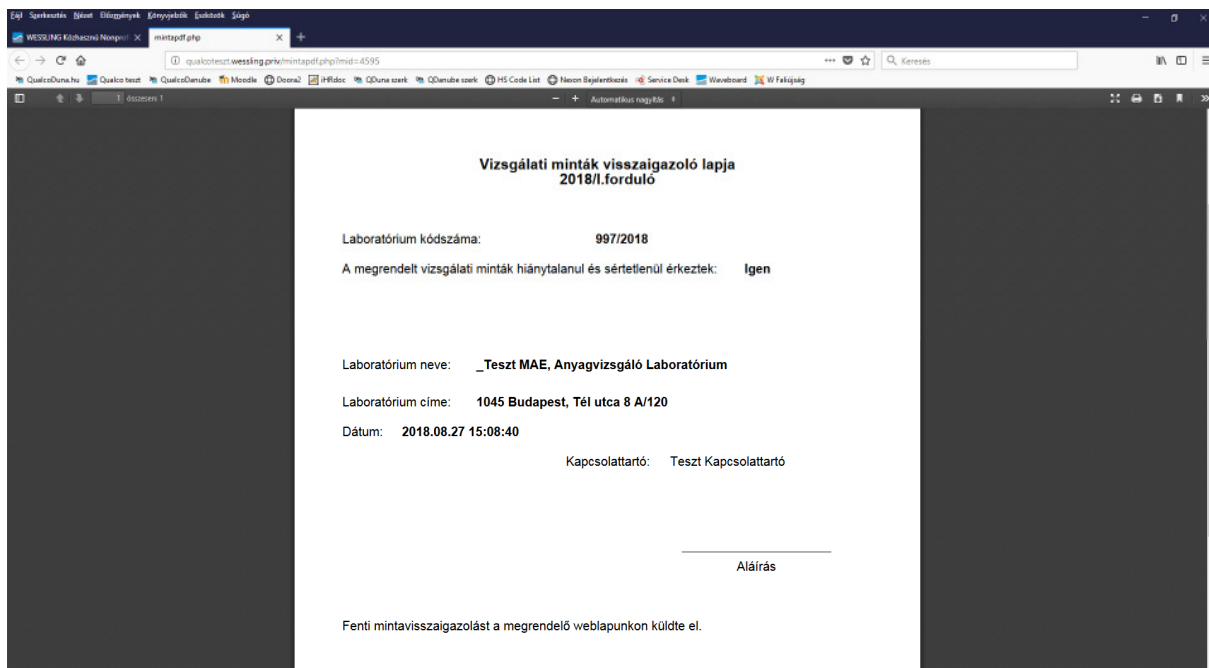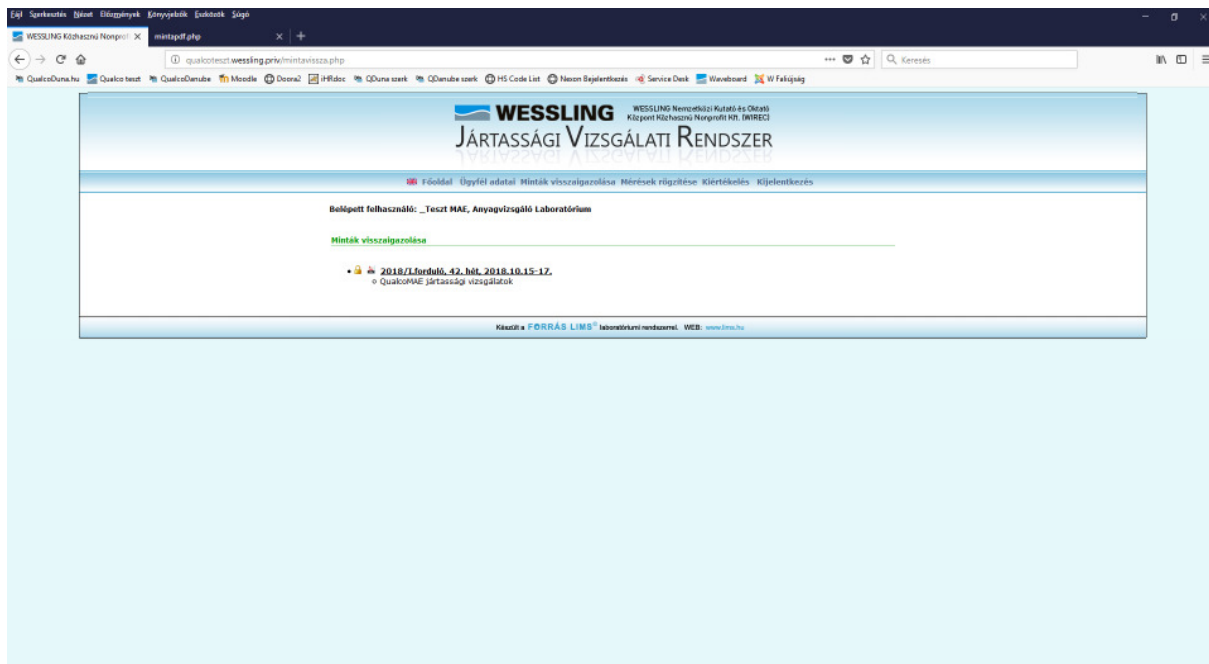

## Eredmények rögzítése

A QualcoMAE jártassági vizsgálatok honlapján felhasználónevünk és jelszavunk segítségével lépünk be az Elektronikus ügyintézés menüpontba.

A Főmenüben válasszuk ki a **Mérések rögzítése** menüpontot. Az eredményközlő adatlapokat a megfelelő témakör alatt levő **Új eredmények rögzítése** szövegre kattintva tudjuk megnyitni.

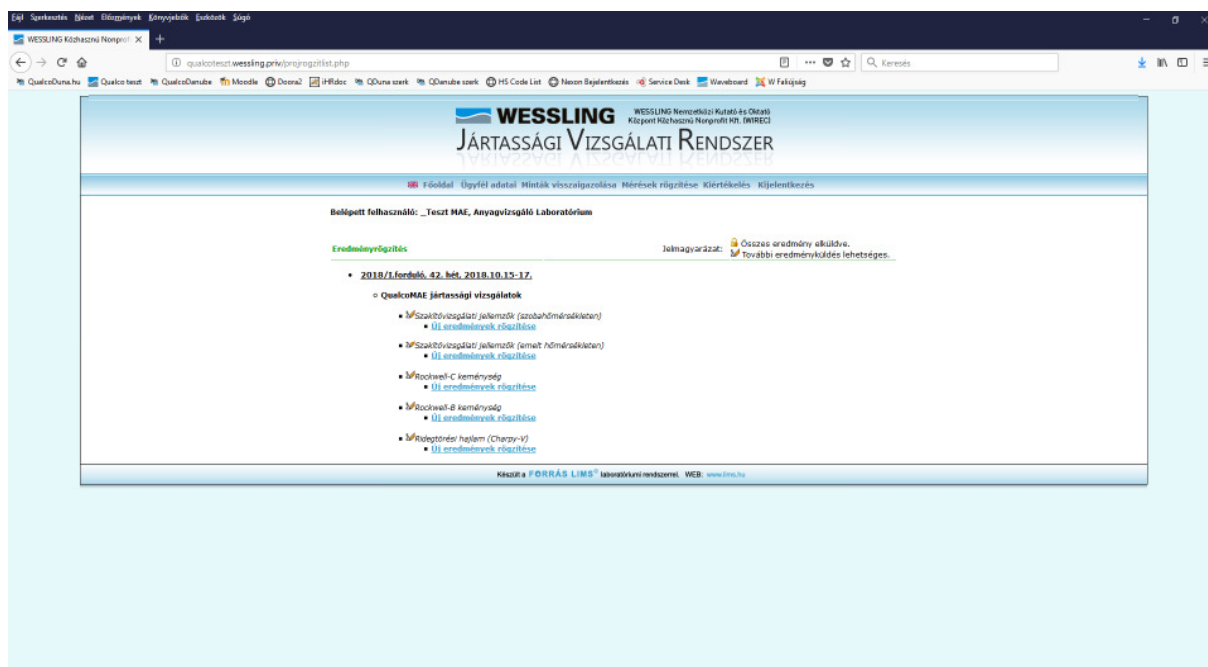

Itt adhatjuk meg valamennyi anyagtulajdonság esetén mindkét mintára a mérési eredményt és annak kiterjesztett mérési bizonytalanságát, valamint a vizsgálat időpontját év/hó/nap formátumban. Az alkalmazott szabvány és méréstechnika a legördülő menüből választható ki.

Lehetőség van arra, hogy egyszerre csak néhány anyagtulajdonságra töltsük ki a táblázatot (a példában Százalékos szakadási megnyúlásra), és később folytassuk az eredményközlést. A korábban már beküldött eredmények dőlt betűvel szerepelnek a táblázatban, ezek módosítására már nincsen lehetőség.

WESSLING JÁRTASSÁGI VIZSGÁLATI RENDSZER

Beleptett felhasználó: \_Tevet MAE, Anyagvizsgáló laboratórium

QualcoMAE jártassági vizsgálatok

ADATLAP

**SAKÍTÓVIZSGÁLATI JELLENZŐK (SZOBANMÉRÉSKELETEN) vizsgálata**

Az eredmények egy paraméterhez is beírhatók, az adott sor valamennyi mezőjébe kitölthető.

A beírt adatok elküldése az ESEMÉNYEK gomb megnyomása után lehetséges. Az adatokat paraméterenként (a sorokat) külön-külön is lehet küldeni, a hiányzó paraméterek adatai későbbi időpontban is megadhatók.

A már beírt adatok eredmények a táblázatban ottlan színnel jelennek meg. További eredmények az új mező kitöltésével tud megadni.

Kérjük, hogy a kitöltéssel mérési bizonytalanságokra a Működési Útmutató Dokumentációjában szereplő (váltott) bizonytalanságokat adja meg az eredmények mértékegységében kifejezve.

Laboratórium kódja: / 2018 Beküldés határideje: 2018.11.19

Anyagtulajdonosság [Mértékegység]	Minta jele	Eredmény	Kiterjesztett mérési bizonytalanság (k=2)	Szabvány, előírás	Méréstechnika	Vizsgálat időpontja
Szaklétes szakadási megnyúlás (A) $[\%]$	SVV_TR-1	15	#1		Válasszon méréstechnikát...	
	SVV_TR-2	18	#1		Válasszon méréstechnikát...	
Szakléteskomarandófoszlatkiváltozás(A <sub>1</sub> ) $[\%]$	SVV_TR-1		#	MSZ EN ISO 6892-1:2016	Válasszon méréstechnikát...	
	SVV_TR-2		#	Egyéb, épesség	Válasszon méréstechnikát...	
Szaklétesjelnyúlósságmax. terheléskor (A <sub>pl</sub> ) $[\%]$	SVV_TR-1		#		Válasszon méréstechnikát...	
	SVV_TR-2		#		Válasszon méréstechnikát...	
Szakléteskiszéplékenyülésságmax. terheléskor(A <sub>pl</sub> ) $[\%]$	SVV_TR-1		#		Válasszon méréstechnikát...	
	SVV_TR-2		#		Válasszon méréstechnikát...	
Szaklétesjelnyúlósságakadaskor(A <sub>1</sub> ) $[\%]$	SVV_TR-1		#		Válasszon méréstechnikát...	
	SVV_TR-2		#		Válasszon méréstechnikát...	
Szaklétes keresztmetszet-csökkenés (Z) $[\%]$	SVV_TR-1		#		Válasszon méréstechnikát...	
	SVV_TR-2		#		Válasszon méréstechnikát...	
Szakléteslőrésdég(R <sub>90</sub> ) $[MPa]$	SVV_TR-1		#		Válasszon méréstechnikát...	
	SVV_TR-2		#		Válasszon méréstechnikát...	
Felsőfolyáshatár(R <sub>90</sub> ) $[MPa]$	SVV_TR-1		#		Válasszon méréstechnikát...	
	SVV_TR-2		#		Válasszon méréstechnikát...	

WESSLING JÁRTASSÁGI VIZSGÁLATI RENDSZER

Beleptett felhasználó: \_Tevet MAE, Anyagvizsgáló laboratórium

QualcoMAE jártassági vizsgálatok

ADATLAP

**SAKÍTÓVIZSGÁLATI JELLENZŐK (SZOBANMÉRÉSKELETEN) vizsgálata**

Az eredmények egy paraméterhez is beírhatók, az adott sor valamennyi mezőjébe kitölthető.

A beírt adatok elküldése az ESEMÉNYEK gomb megnyomása után lehetséges. Az adatokat paraméterenként (a sorokat) külön-külön is lehet küldeni, a hiányzó paraméterek adatai későbbi időpontban is megadhatók.


A már beírt adatok eredmények a táblázatban ottlan színnel jelennek meg. További eredmények az új mező kitöltésével tud megadni.

Kérjük, hogy a kitöltéssel mérési bizonytalanságokra a Működési Útmutató Dokumentációjában szereplő (váltott) bizonytalanságokat adja meg az eredmények mértékegységében kifejezve.


Laboratórium kódja: / 2018 Beküldés határideje: 2018.11.19

Anyagtulajdonosság [Mértékegység]	Minta jele	Eredmény	Kiterjesztett mérési bizonytalanság (k=2)	Szabvány, előírás	Méréstechnika	Vizsgálat időpontja
Szaklétes szakadási megnyúlás (A) $[\%]$	SVV_TR-1	15	#1		Válasszon méréstechnikát...	
	SVV_TR-2	18	#1		Válasszon méréstechnikát...	
Szakléteskomarandófoszlatkiváltozás(A <sub>1</sub> ) $[\%]$	SVV_TR-1		#	MSZ EN ISO 6892-1:2016	Válasszon méréstechnikát...	
	SVV_TR-2		#	Egyéb, épesség	Válasszon méréstechnikát...	
Szaklétesjelnyúlósságmax. terheléskor (A <sub>pl</sub> ) $[\%]$	SVV_TR-1		#		Válasszon méréstechnikát...	
	SVV_TR-2		#		Válasszon méréstechnikát...	
Szakléteskiszéplékenyülésságmax. terheléskor(A <sub>pl</sub> ) $[\%]$	SVV_TR-1		#		Válasszon méréstechnikát...	
	SVV_TR-2		#		Válasszon méréstechnikát...	
Szaklétesjelnyúlósságakadaskor(A <sub>1</sub> ) $[\%]$	SVV_TR-1		#		Válasszon méréstechnikát...	
	SVV_TR-2		#		Válasszon méréstechnikát...	
Szaklétes keresztmetszet-csökkenés (Z) $[\%]$	SVV_TR-1		#		Válasszon méréstechnikát...	
	SVV_TR-2		#		Válasszon méréstechnikát...	
Szakléteslőrésdég(R <sub>90</sub> ) $[MPa]$	SVV_TR-1		#		Válasszon méréstechnikát...	
	SVV_TR-2		#		Válasszon méréstechnikát...	
Felsőfolyáshatár(R <sub>90</sub> ) $[MPa]$	SVV_TR-1		#		Válasszon méréstechnikát...	
	SVV_TR-2		#		Válasszon méréstechnikát...	



Az adatkitöltés befejezése után a táblázat alatti gombra kattintva ellenőrizhetjük a bevitt adatok megfelelőségét elküldés előtt.

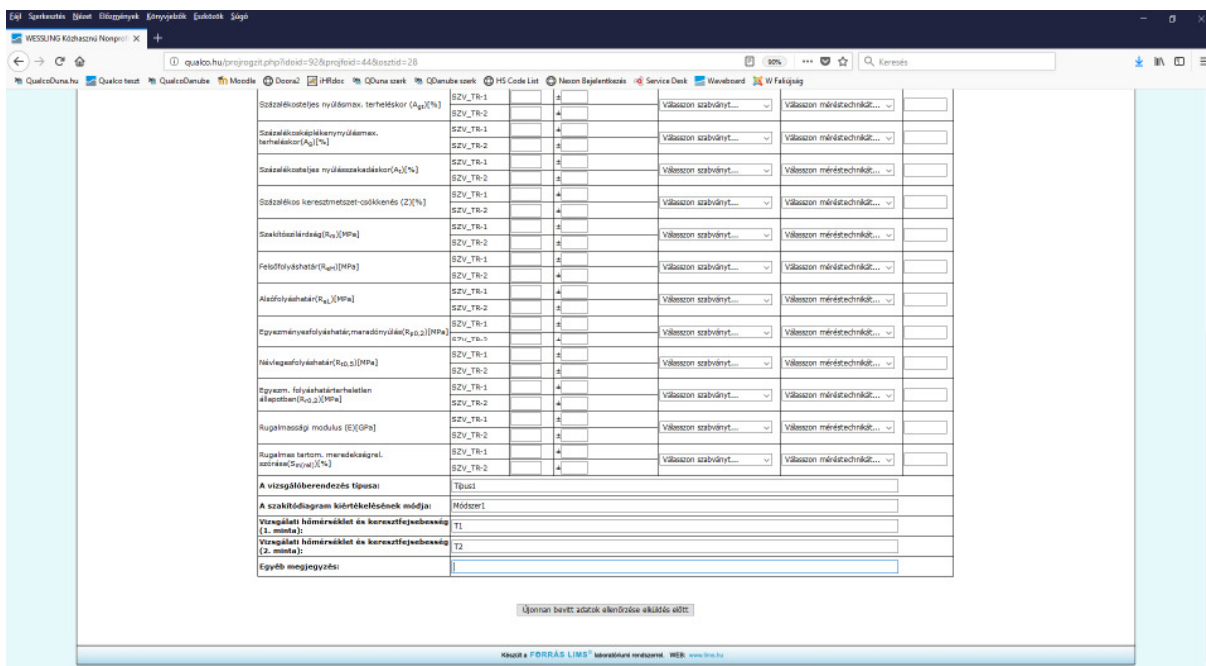

A következő képernyőn csak a jelenleg beküldésre váró adatokat látjuk. Ha módosítani szeretnénk, a **Vissza** gombra kattintva visszatérhetünk az előző képernyőhöz és elvégezhetjük a szükséges változtatásokat. Ha az adatokat megfelelőnek találjuk, az **Elküldés** gombra kattintva küldhetjük be adatainkat. Ezt követően az adatok módosítására weben keresztül nincsen lehetőség.

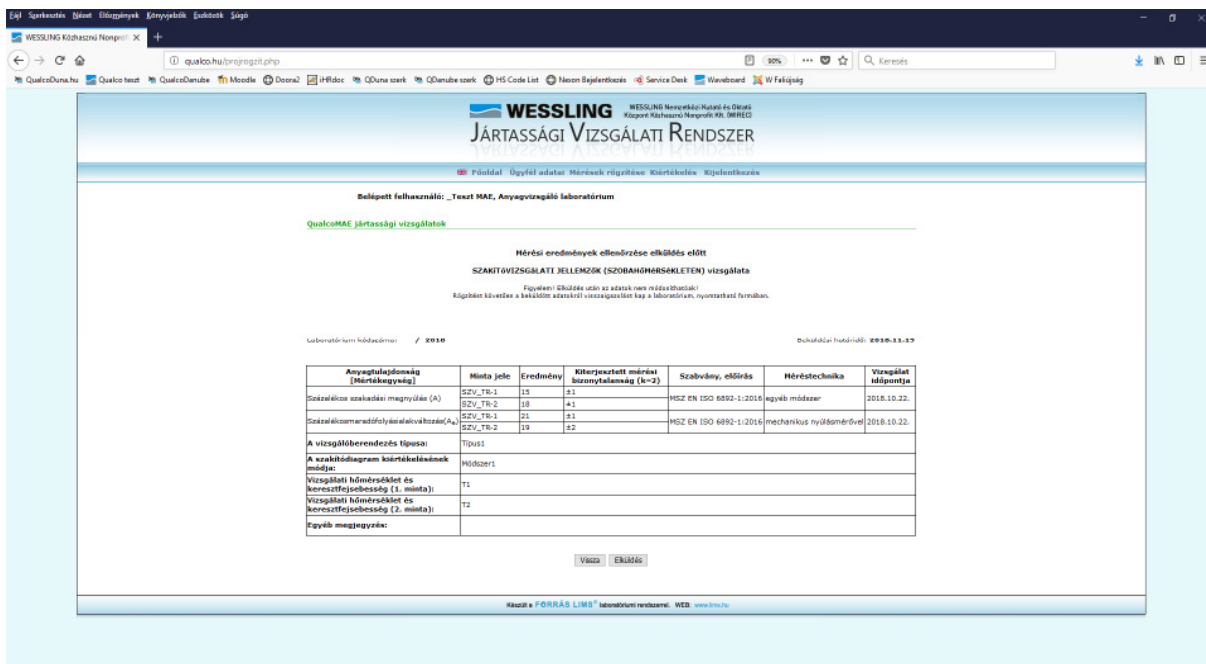

Az adatok elküldését követően a **Mérések rögzítése** oldalra jutunk vissza. Folytathatjuk az eredményközlést másik témakörrel, vagy megnézhetjük és kinyomtathatjuk a már beküldött adatokat a **Korábban rögzített eredmények visszaigazolásának nyomtatása** sor alatti linkekre kattintva. A megjelenő pdf fájlt/fájlokat elmenthetjük vagy kinyomtathatjuk saját használatra.

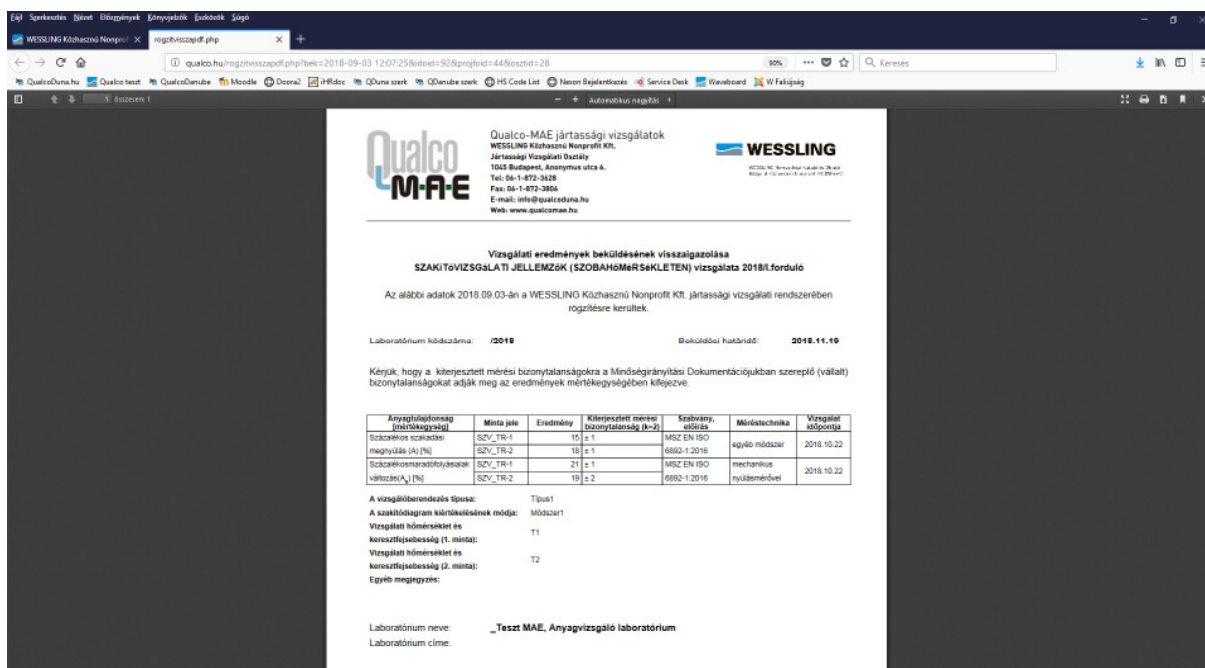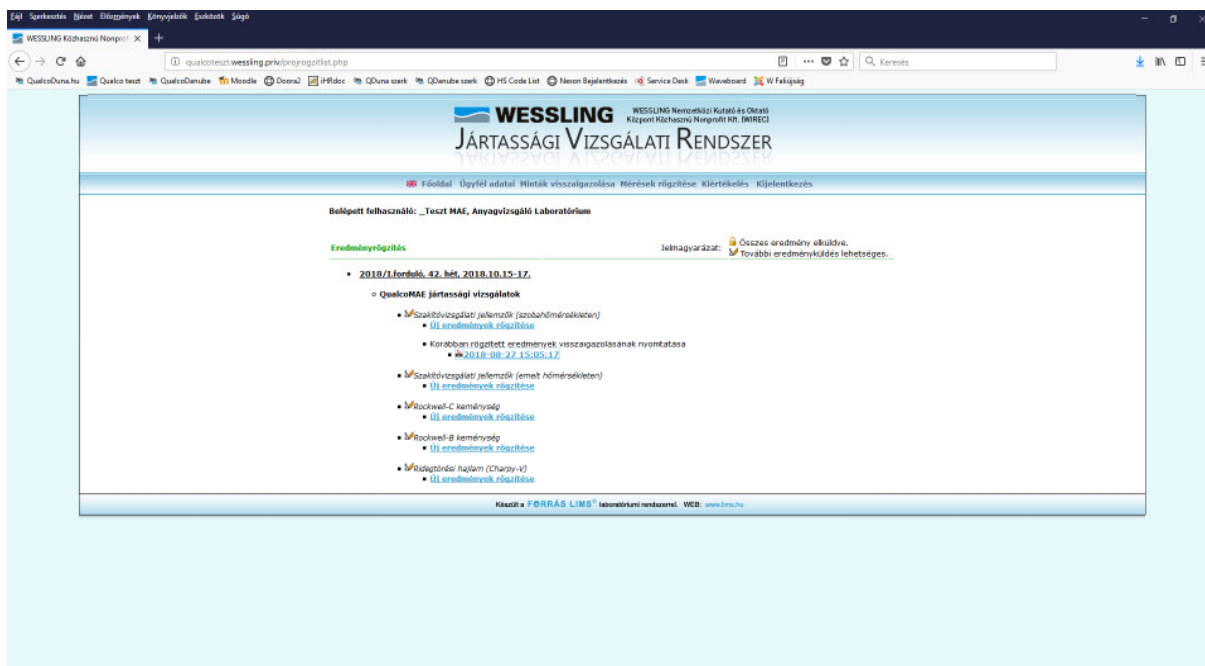

## Eredmények kiértékelésének lekérdezése

A QualcoMAE jártassági vizsgálatok honlapján felhasználónevünk és jelszavunk segítségével lépünk be az Elektronikus ügyintézés menüpontba.

A **Kiértékelés** menüpont alatt érhetjük el a jártassági vizsgálati zárójelentéseket valamint kérdezhetjük le anyagtulajdonságoként a jártassági vizsgálati eredmények kiértékelését. Ehhez először válasszuk ki a jártassági vizsgálati évet, program nevét, a fordulót és a témakört.

Válasszuk ki a bal oldali legördülő menüből a kívánt anyagtulajdonság nevét. A megjelenő táblázat fölötti ikonok segítségével az anyagtulajdonság kiértékelésének adott részét vagy egészét tudjuk megjeleníteni majd kinyomtatni.

Amennyiben csak az adott fordulóban általunk beküldött eredmények kiértékelését szeretnénk látni, válasszuk ki a laboratóriumi kódunkat a jobb oldali legördülő menüből.

Az adott fordulóhoz tartozó zárójelentést a jobb oldali pdf ikonra kattintva érhetjük el.

Amennyiben további segítségre lenne szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az [info@qualcoduna.hu](mailto:info@qualcoduna.hu) e-mail címen.

--- A dokumentum VÉGE ---